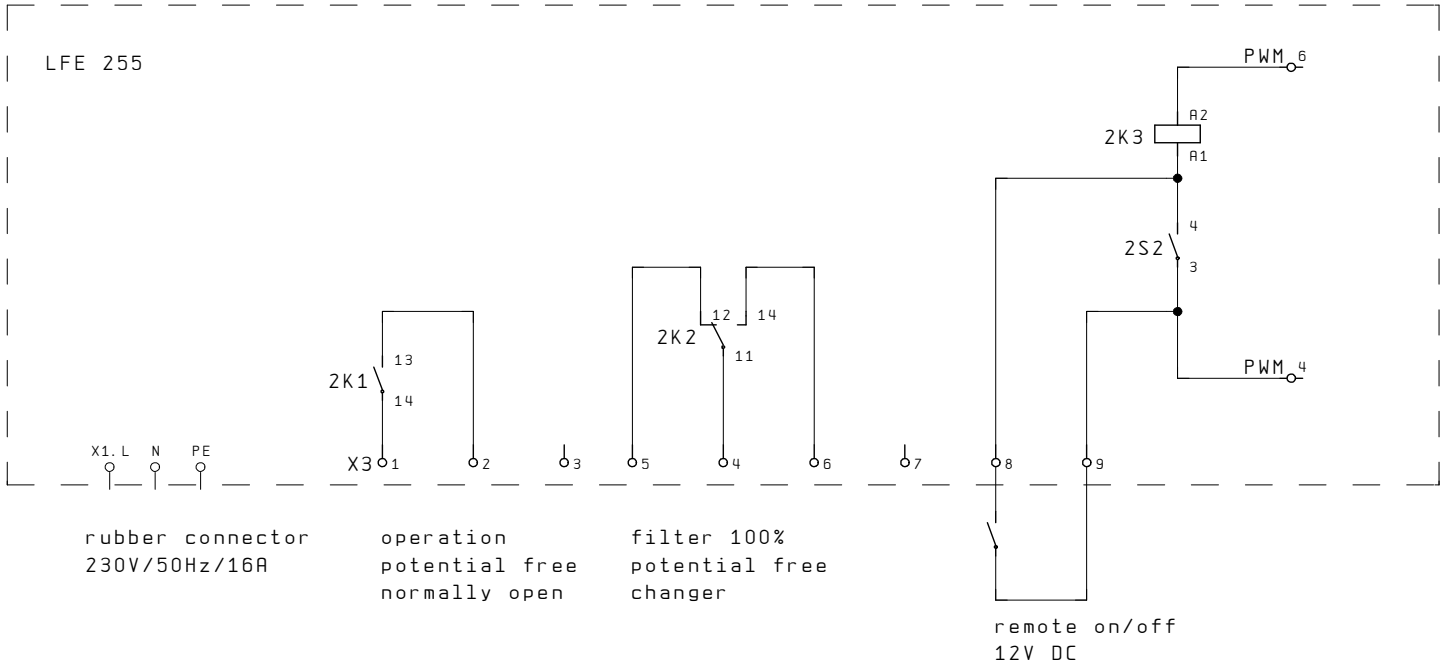


X3 X2 SUB D9-female
X3: 1/2 output operation via potential free normally open
X3: 4/5/6 output filter 100% via potential free changer
X3: 8/9 external remote on/off via normally open contact
2S2 bridge circuit remote on/off

				ULT AG Am Göpeöteich 1 02708 Löbau			Benennung ULT 160.1-1 230V	
002	Bezeichnung	08.05.14	THEI	2011	Datum	Name	Zeichnungsnummer: ULT 160_60_001_101	Seite 6 6 Seiten
002	Erstellung	31.05.	RSCH	Bearb.	31.05	RSCH		
Aus-gabe	Änderung	Tag	Name	Gepr.				